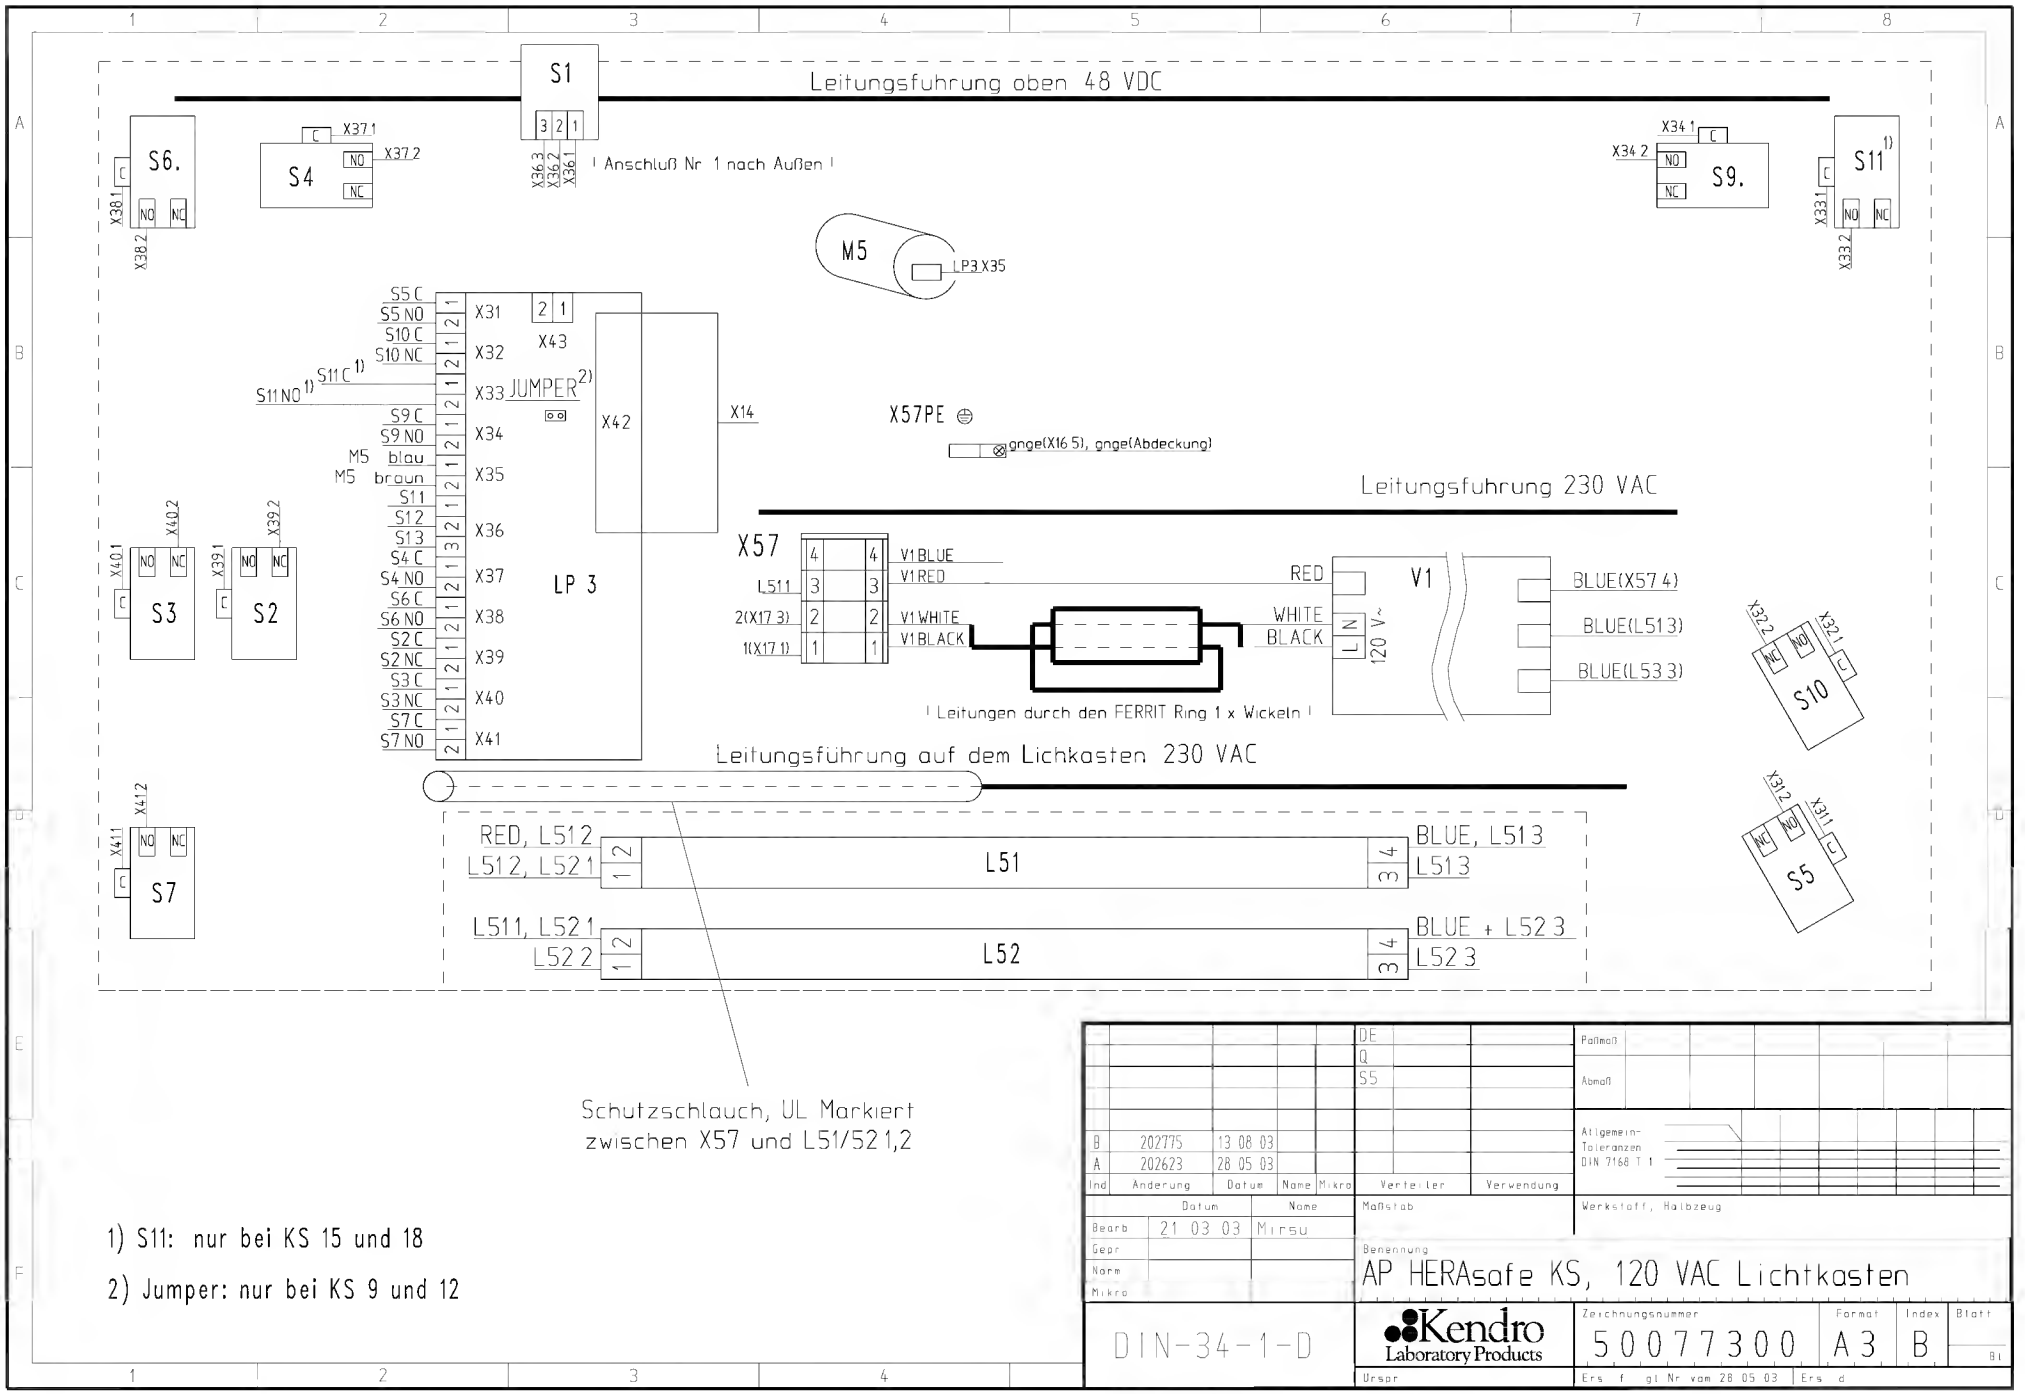

1) S11: nur bei KS 15 und 18

2) Jumper: nur bei KS 9 und 12

Ind	Änderung	Datum	Name
B	202775	13 08 03	
A	202623	28 05 03	

	Datum	Name
Bearb	21 03 03	Mirsu
Gepr		
Norm		
Mikro		

DE
Q
S5

Verteiler | Verwendung

Paßmaß
Abmaß
Allgemeintoleranzen DIN 7168 T 1

Maßstab
Werkstoff, Halbzeug

Benennung
AP HERAsafe KS, 120 VAC Lichtkasten

DIN-34-1-D

Kendro Laboratory Products

Zeichnungsnummer	Format	Index	Blatt
50077300	A3	B	Bl

Ursp | Ers f gl Nr vom 28 05 03 | Ers d